

精度保証概要

2023 年度版

○ 当社の精度保証概要 ○

当社の『精度保証概要』は、患者の正確な診断を確実にするための基本方針や品質管理手順を網羅した文書です。標準化された検査手法の適用と検査装置の正確な校正を通じて、検査結果の信頼性を確保します。さらに、外部の独立機関による定期的な監査や評価を実施し、検査プロセス全体の品質を保つ努力が含まれます。これにより、患者の安全性と診断の正確性が向上し、臨床検査が医療の基盤として信頼される状態が維持されます。

○ 当社の精度管理 ○

当社は、企業理念である“EQTASS”を具現化するために、以下を実施しています。当社は企業理念 EQTASS に基づき、精度管理において最高水準を追求しています。外部精度管理においては、日本臨床衛生検査技師会サーベイ・東京都衛生検査所精度管理調査に参加しています。

内部精度管理では、社内品質マニュアル (QM)、規定、その他マニュアルに沿って、日々の作業日誌に記録し、病理組織精度管理・細胞診内部フォトサーベイ・内部スクリーニングサーベイ・既知標本管理・症例検討会などを実施しています。これらの手法により、検査の精度を維持し向上させております。

さらに、積極的に学会・地方会・研修会に参加し、最新の技術の知見や技術の習得に邁進しています。

我々は患者に安心と信頼を提供し、高品質な検査結果をお届けすることに真摯に取り組んでいます。EQTASS の価値観を胸に、医療に貢献し続けます。

○ 外部精度管理参加状況 成績 ○

①東京都衛生検査所精度管理調査



1,病理組織検査

	2022 年度
薄切	A
核染色	A
細胞質染色	A
間質染色	A
封入	A
バランス	B
総合	A

②日本臨床衛生検査技師会精度管理調査

	2022 年度	2023 年度
病理検査 評価/正解率	A/100%	A/100%
細胞検査 評価/正解率	A/100%	A/100%

精度管理担当者組織図

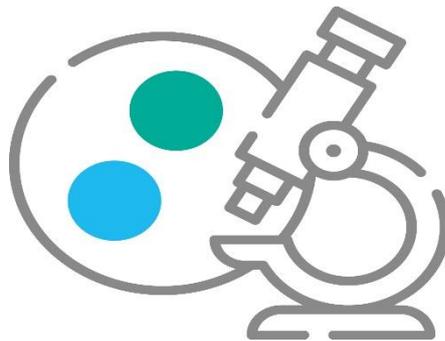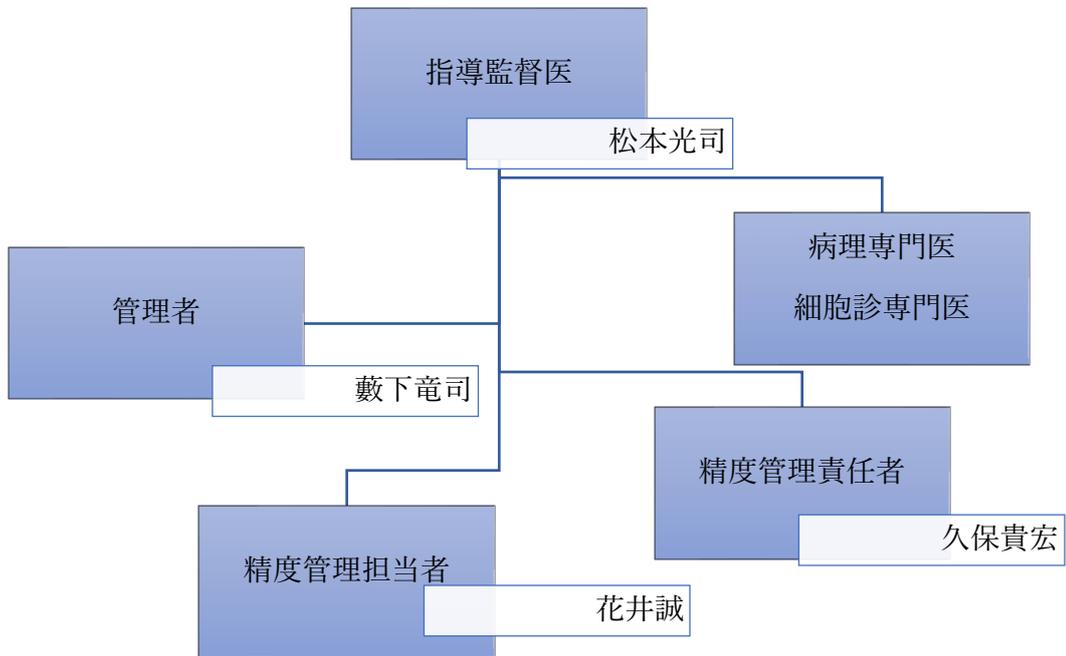

株式会社病理細胞診 MEDIGLANZ LABORATORY

〒192-0372

東京都八王子市下柚木 2-5-23 アーネストNo.2 5号室

電話 090-7769-9560 FAX0426-82-5885